

مستشفيات جامعة الزقازيق  
ادارة المشتريات والمخازن

السيد الاستاذ / مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة

بعد التحية،،،

- نتشرف ان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشرة التالية:-

م	اسم العملية	الكمية	طريقة الطرح	الارتباط بالعرض	اسلوب التقييم	اخر موعد لتقديم عرض السعر	اسم الموظف	ملاحظات
١	مقاييس اصلاح محطة مياه الكلى الصناعي المتنقلة	١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	ناهد /	وذلك بالامر المباشر طبقاً لمواد قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
٢	تغيير بطارية لجهاز صدمات قلب ماركة mri	١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	سامح /	
٣	تغيير flash او تغيير بطارية لسرنجة محاليل موديل agilia	١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	ناهد /	
٤	تغيير البوردة الرئيسية لزوم جهاز مونتور موديل nt3	١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	ناهد /	
٥	بعض الاصناف لزوم الفائز بمحطة المياه	١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	سامح /	
٦	اصلاح دائرة الشحن وتركيب بطارية لزوم جهاز صدمات inomeed ماركة	٤	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	سامح /	
٧	مقاييس اصلاح جهاز رسم العصب والعضلات موديل nemus	١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	سامح /	
٨	مقاييس توريد بعض مستلزمات water path جهاز	١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	ناهد /	
٩	مقاييس توريد مستلزمات تشغيل جهاز مونتور ماركة co2	١٩	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	سامح /	
١٠	سرحة انجكتور	٥٠	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	اريح ا	
١١	شريان حلقى ptfte	٢٠	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	اريح ا	
١٢	وصلة شريان الثبات caroted shunt	١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	اريح ا	
١٣	كابلات مونتور	٥١	امر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٢/٩/٩	اريح ا	

- مرفق جميع المواصفات لكل بند عملية على حدة.

- المستندات المطلوبة:-

- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب - البطاقة الضريبية سارية - التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - شهادة القيمة المضافة - السجل التجارى السارى - الفاتورة الالكترونية - وعلى ان تكون الشركة مسجلة بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى ادارة المشتريات .
- مكان تقديم العروض:-
- جامعة الزقازيق - الادارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق - ادارة المشتريات والتعاقدات - الدور الثاني علوى.
- برفاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة والموقع الالكتروني للجامعة .

مرسل للعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلاً سيداتكم بقبول فائق الاحترام،،،

للأستفسار الاتصال  
على رقم: ٠١١١١٢٩٦١٢٠



- اصناف البند الاول :-

الصنف	الكمية
اصلاح محطة مياة الكلى الصناعي المتنقلة	١

- اصناف البند الثاني :-

الصنف	الكمية
تغيير بطارية لجهاز مونتور ماركة pic2 رقم ٨٢٩١ موديل mri	١

- اصناف البند الثالث :-


الصنف	الكمية
تغيير flash memory لزوم سرنجة محاليل موديل رقم 19503066 jagilia	١
تغيير بطارية لزوم سرنجة محاليل موديل رقم 19503066 jagilia	١

- اصناف البند الرابع :-

الصنف	الكمية
تغيير بوردة رئيسية لزوم مونتور موديل nt3 رقم اصلاح nt309060029	١
اصلاح distribution board لزوم مونتور موديل nt3 رقم nt309060029	١

- اصناف البند الخامس :-

الصنف	الكمية
شحنة رمل للفلتر الرملي ١١٢ التر	١
شحنة كربون ١١٢ التر	١
شحنة رزن ١١٢ التر	١
راس تحكم كلاك	١

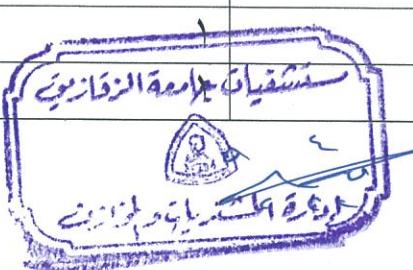

- اصناف البند السادس :-

الكمية	الصنف
٢	اصلاح دائرة الشحن لزوم جهاز صدمات قلب ماركة cardio inomeed موديل aid200 رقم 0305192/03085194
٢	تركيب بطارية لزوم جهاز صدمات قلب ماركة cardio inomeed موديل aid200 رقم 0305192/03085194

- اصناف البند السابع :-

الكمية	الصنف
١	اصلاح جهاز رسم العصب والعضلات ماركة nemus موديل 00655 رقم ebnuro

- اصناف البند الثامن :-

الكمية	الصنف
١	طقم برسات تحكم لجهاز water ماركة n-path موديل 9304114 piotek
١	دائرة فيوز حماية لجهاز water ماركة n-path موديل 9304114 piotek
١	كابلات توصيل البوردة لجهاز water path ماركة n-path موديل 9304114 piotek



- اصناف البند التاسع :-

الصنف	الكمية
Mini d-fend water trap 10/box	٤
Water trap d-fend pro 10/box	٤
d-fend water trap black	١
Gas sampling lines box	١٠

- اصناف البند العاشر:-

الصنف	الكمية
سرنجة انجكتور ماركة medrad salient 190ml syringes with qft	٥٠

- اصناف البند الحادى عشر:-

الصنف	الكمية
الشريان الحلقى الثباتى ptfte	٢٠

- اصناف البند الثانى عشر:-

الصنف	الكمية
وصلة الشريان الثباتى caroted shunt	١

- اصناف البند الثالث عشر:-

الصنف	الكمية
كابل رسم قلب لمونتور GE	٦
كابل طرف رسم قلب لمونتور GE	٦
كابل لمونتور SPO2 GE	٦
كابل ضغط NIBP لمونتور GE	٩
كف ضغط مقاس ٣٥-٢٥	
كف ضغط مقاس ٤٧-٣٢	

